

Blutdruck
eines wetterempfindlichen Patienten (Nr. 498)
(nach Pantschenko - Kiew)

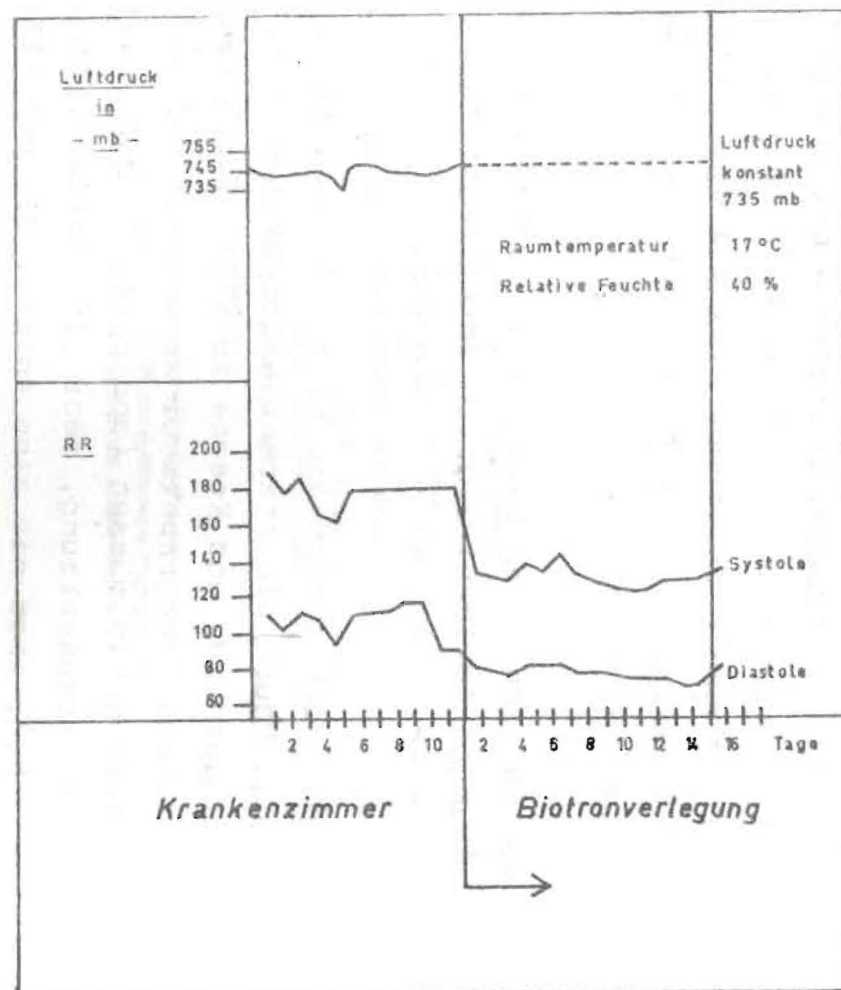


Abb. 10

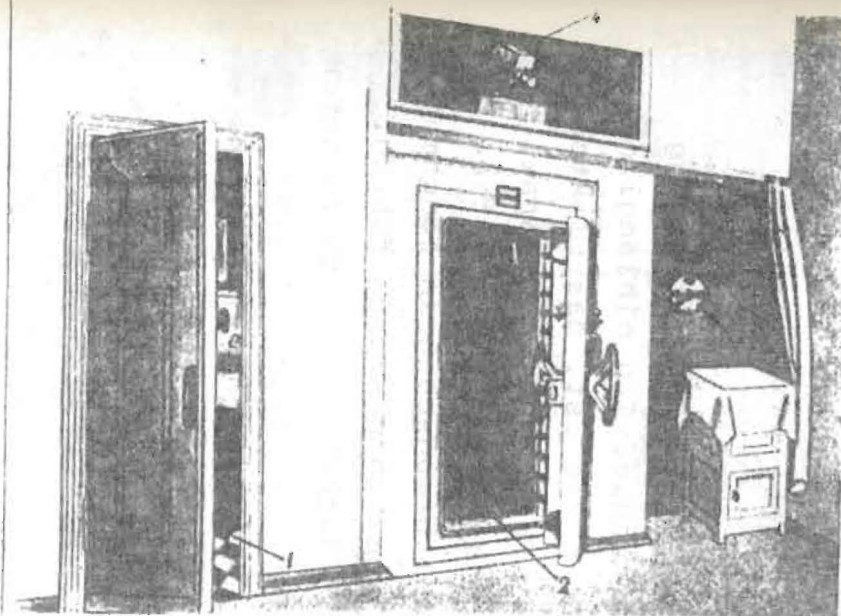


Рис. 9. Внешний вид части палаты биотрона:
1 — санузел; 2 — входной шлюз; 3 — почтовый шлюз; 4 — поворотная телевизионная головка.

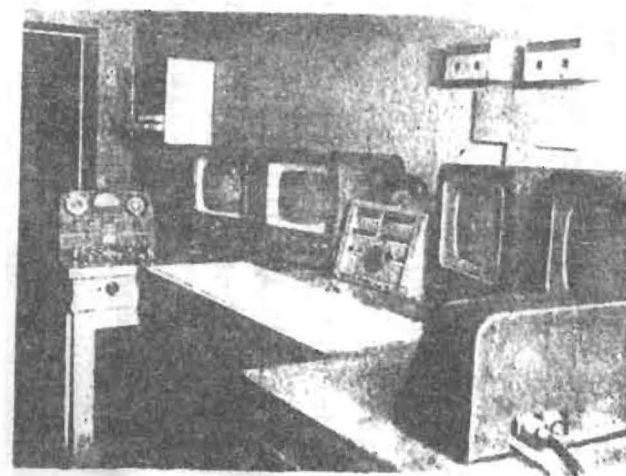


Рис. 10. Пульт врачебного контроля.

Abb. 9